
Катод E047 · 129108S

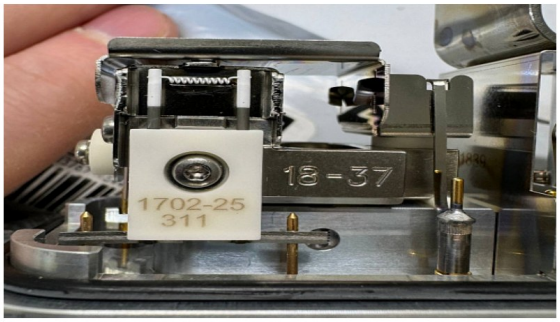

Катод E047 · 129108S

Технические характеристики

Изделие / исполнение	Катод E047 · 129108S
Размещение запаса	Склад лаборатории, Санкт-Петербург
Количество на дату перечня	1 шт.
Дата сведений о наличии	29.09.2026
Подтверждённые сведения об исполнении	Катод для ячейки анализатора 3G. Совместимость сверяем по исполнению ячейки.

Параметр	Значение
Наименование изделия	Катод для течеискателя E047
Каталожный номер	129108S
Назначение	Замена катода в ячейке анализатора 3G гелиевого течеискателя
Тип узла	Катод аналитической ячейки
Совместимость	Течеискатели, использующие ячейку анализатора 3G
Основная функция	Обеспечение ионизации пробного газа в анализаторе
Роль в работе прибора	Формирование стабильного аналитического сигнала и поддержание чувствительности
Применение	Сервисное обслуживание, восстановление характеристик, плановая замена изношенного катода

Преимущество	Практический результат
Высокая чувствительность	Уверенное обнаружение малых утечек и более точная работа течеискателя
Стабильность ионизации	Снижение дрейфа сигнала и повышение воспроизводимости измерений
Быстрый отклик прибора	Сокращение времени реакции на появление гелия в контролируемой зоне

Преимущество	Практический результат
Поддержание штатных характеристик анализатора	Сохранение расчетной чувствительности ячейки 3G
Снижение риска ложных отклонений в работе	Повышение надежности испытаний и качества диагностики
Эффективность сервисного ремонта	Быстрое восстановление работоспособности течеискателя при замене изношенного элемента

Комплектование и обслуживание вакуумного оборудования

Катод E047 · 129108S

Катод для ячейки анализатора 3G. Совместимость сверяем по исполнению ячейки.

Комплектность конкретного экземпляра фиксируем в техническом предложении.

Характеристики и исполнение

Параметры, не указанные в таблице, уточняем по паспорту и чертежу выбранного исполнения. Характеристики аналогичных изделий не являются характеристиками этого компонента. Свободный остаток и дату отгрузки подтверждаем перед заказом.

Дополнительные технические данные модели или серии

Таблицы из действующего описания модели. При наличии нескольких исполнений параметры выбирают по обозначению соответствующей колонки.

Назначение и принцип работы

Компонент выбирают для конкретного прибора или системы с учётом назначения и конструкции. Внешнее сходство не подтверждает совместимость. Сервисные узлы, фильтры и электрические детали имеют разные критерии подбора.

Как подобрать исполнение

Сверьте обозначение компонента, модель основного оборудования, размеры и присоединения. Для электрических деталей уточняют распиновку и питание; для фильтров — среду, проход и обслуживание. Подбор замены требует проверки документации и фактического узла.

Монтаж и обслуживание

Перед заменой отключите оборудование и приведите систему в безопасное состояние по руководству. После установки проверьте герметичность, электрические соединения и рабочие режимы. Зафиксируйте заменённую деталь и результаты проверки.

Проверка перед вводом в работу

Сопоставьте поставленное исполнение с согласованной спецификацией. Проверьте обозначение, присоединения и комплектность. Для вакуумного узла после сборки выполняют контроль герметичности в рабочей схеме; для измерительного прибора — проверку работоспособности и предусмотренную документацией метрологическую процедуру. Условия проверки и результат фиксируют в документах предприятия.

Описание модели, документы и материалы →

Связанные исполнения

• ULVAC WP-01

• ULVAC IS-BA1

• CBVAC · адсорбционная ловушка 25

• Защитный кофр для ZQJ

• Щуп для масс-спектрометрического течеискателя · 5 м

Подготовка технического предложения

Укажите количество, рабочую среду, условия процесса и обозначение ответного узла. Для замены приложите фотографию шильдика и присоединения. Ликлаб согласует исполнение и комплектность, подберёт совместимые компоненты и определит необходимые проверки перед вводом в эксплуатацию.

Страница изделия: https://leaklab.ru/stock/spec/lab-56511e3dc8d4/